



MOD : EPE-10UN

Production code : T ANEMOS 10/CL UMI

04/2026

10 Dessins éclatés et liste des pièces de rechange

Afin de simplifier la recherche des pannes et l'éventuelle substitution des parties endommagées, vous trouverez ci-dessous une liste des pièces de rechange et les dessins éclatés avec la référence de chaque pièce de la liste.

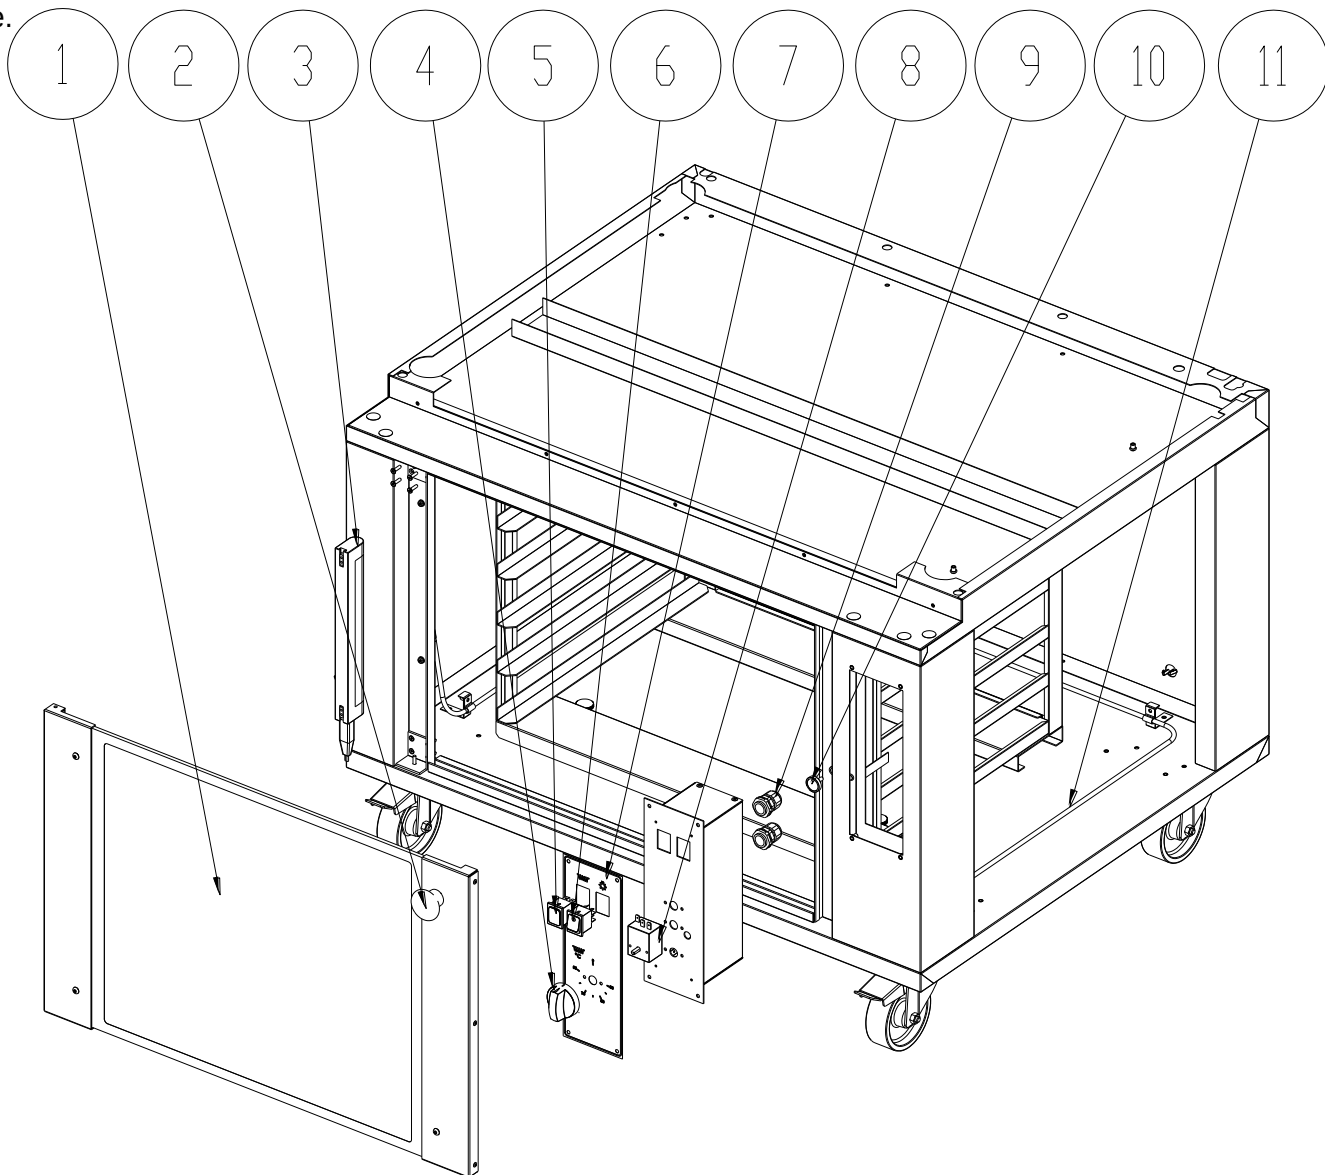


Fig.10.1 Dessin éclaté chambre

N°	Description	Codes T ÀNEMOS E-G /CL H=710	Codes T ÀNEMOS E-G /CL H=1060	Codes COMBI T /CL H=530	Codes COMBI T /CL H=730
1	VITRE DE LA PORTE CHAMBRE	CRIS0125	CRIS0128	CRIS0127	CRIS0124
2	POMMEAU CHAMBRE	MANI0091	MANI0091	MANI0091	MANI0091
3	LAMPE STYLO CHAMBRE	LAMP0048	LAMP0048	LAMP0048	LAMP0048
4	BOUTON THERMOSTAT	MANI0110	MANI0110	MANI0110	MANI0110
5	LAMPE VOYANT	LAMP0068	LAMP0068	LAMP0068	LAMP0068
6	INTERRUPTEUR BIP LUMINEUX 0-1	INTE0037	INTE0037	INTE0037	INTE0037
7	PANNEAU SERIGRAPHE	PANN0524	PANN0524	PANN0524	PANN0524
8	THERMOSTAT 0-90°CHAMBRE	TERM0002	TERM0002	TERM0002	TERM0002
9	PASSE-FILS PG13.5	ELET0090	ELET0090	ELET0090	ELET0090
10	AIMANT PORTE CHAMBRE	MECC0578	MECC0578	MECC0578	MECC0578
11	RESISTANCE CHAMBRE	RESI0008	RESI0008	RESI0008	RESI0008

TAB.10.1 Tableau des pièces de rechange

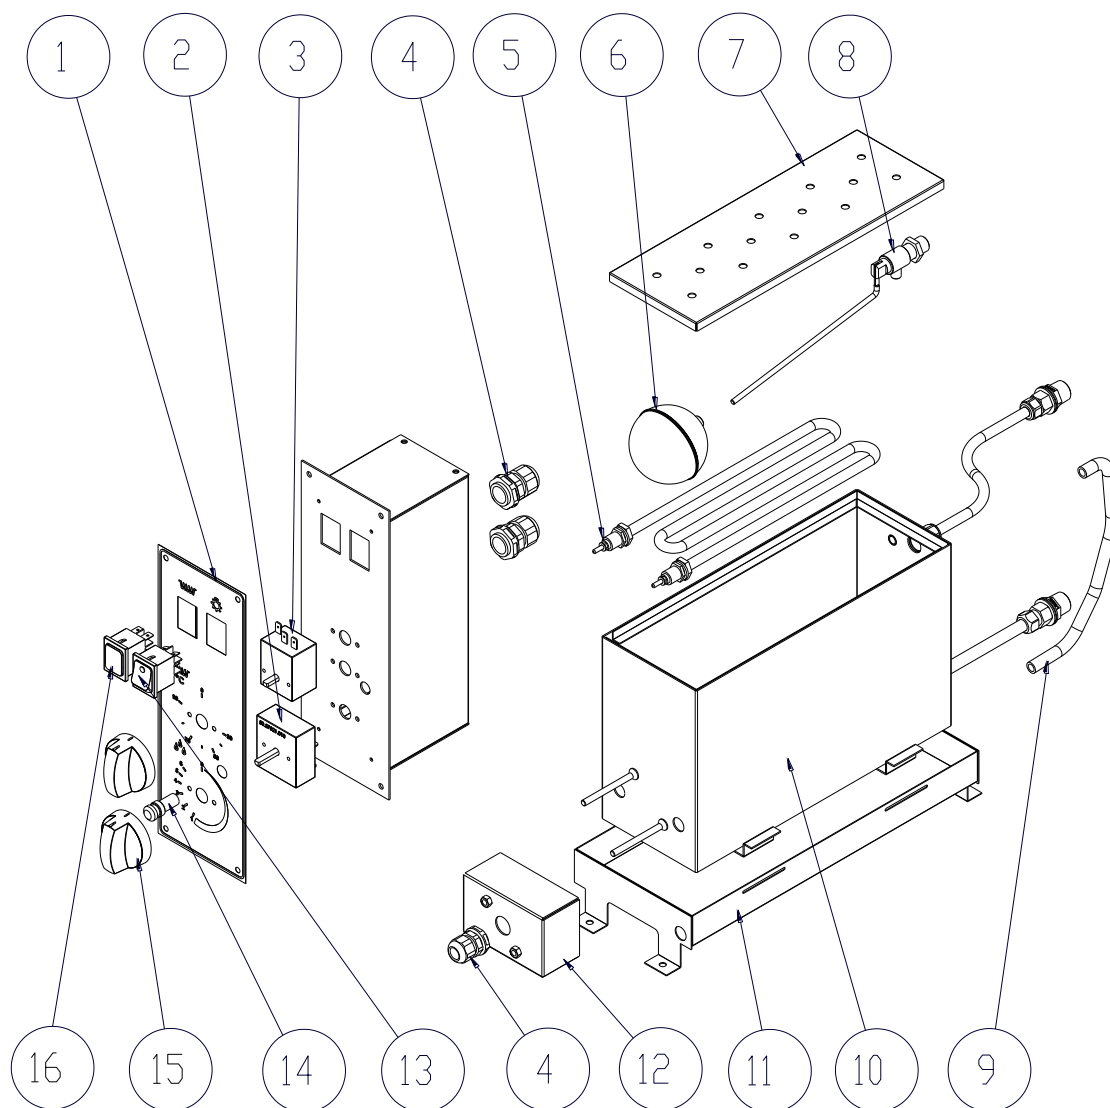


Fig.10.2 Dessin éclaté humidificateur (optionnel)

N°	Description	Codes
1	PANNEAU SERIGRAPHE	PANN0525
2	REGULATEUR D'ENERGIE	TERM0050
3	THERMOSTAT 0-90° CHAMBRE	TERM0002
4	PASSE-FILS PG13.5	ELET0090
5	RESISTANCE HUMIDIFICATEUR CHAMBRE	RESI0016
6	FLOTTEUR HUMIDIFICATEUR	GASI0011
7	COUVERCLE	CAR1704
8	TIGE FLOTTANTE 3/8" HUMIDIFICATEUR	GASI0013
9	TUBE SILICONE	GUAR0035
10	RESERVOIR HUMIDIFICATEUR	CARP1706
11	RESERVOIR DE RECUPERATION HUMIDIFICATEUR	CARP1703
12	COUVERCLE BRANCHEMENT RESISTANCES HUMIDIFICATEUR	CARP1705
13	INTERRUPTEUR BIP LUMINEUX 0-1	INTE0037
14	LAMPE VOYANT ROND	LAMP0069
15	BOUTON THERMOSTAT / REGULATEUR D'ENERGIE	MANI0110
16	LAMPE VOYANT	LAMP0068

TAB.10.2 Tableau des pièces de rechange humidificateur (optionnel)



Collecte différenciée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques normaux. Selon les normes locales, les services pour la collecte différenciée peuvent être disponibles dans chaque point de collecte municipal.